

OCULUS BIOM[®] 5



AUFBEREITUNGSANLEITUNG BIOM[®] 5 UND ZUBEHÖR

Vorwort

Diese Aufbereitungsanleitung zeigt Ihnen die Aufbereitung des BIOM® 5. Sie gilt für alle wieder verwendbaren, steril anzuwendenden Komponenten und Zubehörteile des BIOM® 5.

Der richtige Gebrauch des Gerätes ist für den sicheren Betrieb unerlässlich. Machen Sie sich deswegen vor der Inbetriebnahme mit dem Inhalt dieser Aufbereitungsanleitung gründlich vertraut. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise.

Beschrieben werden in dieser Gebrauchsanweisung die Aufbereitung der BIOM® 5 Modelle:

- BIOM® 5c und 5cl (Langversion)
- BIOM® 5m und 5ml (Langversion)

Geringfügige Abweichungen der in der Gebrauchsanweisung dargestellten Abbildungen von tatsächlich ausgelieferten Geräten sind entwicklungsbedingt möglich. Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns an, mailen oder faxen Sie uns. Unser Serviceteam steht Ihnen gerne zur Verfügung.

OCULUS Optikgeräte GmbH

Artikelnummer: G/55185/DE

Revision: Rev03

Freigabe: 25.02.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise	7
1.1	Verwendete Piktogramme	7
1.1.1	In diesem Handbuch	7
1.1.2	Auf dem Gerät	8
1.2	Sicherheitshinweise zum Gebrauch	8
1.2.1	Hinweise zum Aufbereitungspersonal	8
1.2.2	Hinweise zur Aufbereitung	9
1.2.3	Hinweis zum Rücksenden	9
2	Ablauf der Aufbereitung	10
2.1	Komponenten BIOM® 5 zum Aufbereiten	10
2.2	Vorbereitungen für Reinigung und Desinfektion	12
2.2.1	BIOM® 5 demontieren	12
2.2.2	Vorreinigen	14
2.3	Maschinelle Reinigung/Desinfektion	15
2.3.1	Hinweise zur maschinellen Reinigung/Desinfektion	15
2.3.2	Vorgehen	16
2.4	Manuelle Reinigung/Desinfektion	19
2.4.1	Reinigungsmittel	19
2.4.2	Vorgehen	19
2.5	Reinigen im Ultraschallbad (optional)	20
2.6	Dampfsterilisation	21
2.6.1	Funktionsprüfung vor der Dampfsterilisation	21
2.6.2	Schmieren	23
2.6.3	Verpacken	24
2.6.4	Dampfsterilisation durchführen	24
3	Lagerung und Entsorgung	25
3.1	Lagerung	25
3.2	Entsorgung	25
4	Gewährleistung und Service	26
5	Übersicht: Zulässige Sterilisationsverfahren — Artikelverzeichnis	27
6	Verbrauchsmaterial und sterilisierbares Zubehör	31
7	Anhang	32

1 Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Aufbereitungsanleitung sorgfältig durch.
- Bewahren Sie die Aufbereitungsanleitung sorgfältig auf. Sie müssen während der Aufbereitung eine Zugriffsmöglichkeit auf die Unterlagen haben.
- Beachten Sie die gesetzlichen Unfallverhütungsbestimmungen.
- Beachten Sie für bestimmte Produkte die zusätzlichen Angaben zur Aufbereitung, die diesen beiliegen.

Diese Anleitung steht in der aktuellen Version unter www.oculus.de zum Download zur Verfügung oder Sie können sie bei OCULUS Optikgeräte GmbH anfordern.

1.1 Verwendete Piktogramme

1.1.1 In diesem Handbuch



Vorsicht

Kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Körperverletzungen oder Sachschäden führen kann.



Hinweis

Kennzeichnet Situationen, die zu fehlerhaften Untersuchungsergebnissen führen können, Anwendungshinweise sowie nützliche oder wichtige Informationen.



Information

Kennzeichnet weiterführende Informationen über das Produkt oder dessen Handhabung, auf die besonders aufmerksam gemacht werden soll.

1.1.2 Auf dem Gerät

Beispiel: Bildzeichen auf dem BIOM® 5 Sterilisations-Einsatz

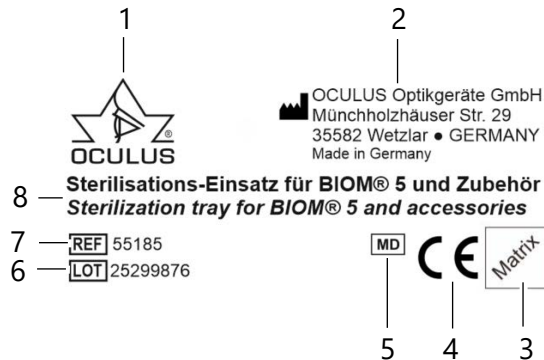


Fig. 1-1: Bildzeichen auf dem BIOM® 5 Sterilisations-Einsatz

Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
1	Hersteller-Logo	5	Medizingerät (Medical Device)
2	Name und Adresse des Hersteller	6	LOT-Nummer
3	Maschinenlesbarer Matrix-Code	7	Artikelnummer
4	CE-Kennzeichnung	8	Artikelbezeichnung

1.2 Sicherheitshinweise zum Gebrauch



Vorsicht

Personen- oder Sachschaden durch falsche Vorgehensweisen bei der Aufbereitung
 → Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise.



Vorsicht

Personen- oder Sachschaden durch sicherheitsgefährdende Geräteänderung
 → Der BIOM® 5 Sterilisations-Einsatz darf ohne Erlaubnis des Herstellers nicht geändert werden.

1.2.1 Hinweise zum Aufbereitungspersonal

- Achten Sie darauf, dass die Aufbereitung ausschließlich von ausgewiesenen Personen durchgeführt wird, die auf Grund ihrer Ausbildung oder ihrer Kenntnisse und praktischen Erfahrung die Gewähr für eine sachgerechte Handhabung bieten.

1.2.2 Hinweise zur Aufbereitung



Vorsicht

Personenschaden durch unsteriles BIOM® 5

Bei Kontakt mit dem Patienten oder dessen Körperflüssigkeiten kann das BIOM® 5 kontaminiert werden, z. B. bei der Ablage.

- Stellen Sie sicher, dass das BIOM® 5 gereinigt, desinfiziert und sterilisiert wird. Bereiten Sie das BIOM® 5 vor dem ersten und jedem weiteren Einsatz auf.
-

- Beachten Sie die in Ihrem Land gültigen Rechtsvorschriften, sowie die Hygiene- und Entsorgungsvorschriften des Krankenhauses bzw. der Klinik.
- Bereiten Sie das BIOM® 5 nur auf, wenn Sie diese Aufbereitungsanleitung verstanden haben.
- Das BIOM® 5 und alle sterilisierbaren BIOM® 5-Komponenten müssen vor dem ersten und jedem weiteren Einsatz gereinigt, desinfiziert und steril aufbereitet werden. Nehmen Sie dazu das BIOM® 5 aus der Lieferverpackung.
- Achten Sie darauf, dass nur geräte- und produktspezifisch validierte Verfahren für die Reinigung / Desinfektion und Sterilisation eingesetzt werden und dass die validierten Parameter bei jedem Zyklus eingehalten werden.
- Setzen Sie maschinelle Verfahren (Desinfektor) für die Reinigung/Desinfektion ein. Dies erhöht deutlich die Wirksamkeit.

1.2.3 Hinweis zum Rücksenden



Vorsicht

Personenschaden durch kontaminiertes BIOM® 5 und Komponenten

- Vor dem Rücksenden an OCULUS: Bereiten Sie das BIOM® 5 und die sterilisierbaren Komponenten entsprechend dieser Aufbereitungsanleitung auf.
 - Senden Sie die OCULUS Produkte nur erkennbar aufbereitet an OCULUS zurück.
-

2 Ablauf der Aufbereitung

- Reinigung/Desinfektion
 - Vorbereitung: BIOM® 5 demontieren
 - Vorreinigen
 - Maschinelle Reinigung/Desinfektion oder
 - Manuelle Reinigung/Desinfektion
- Sterilisation
 - Vorbereitung für die Sterilisation
 - Dampfsterilisation

2.1 Komponenten BIOM® 5 zum Aufbereiten

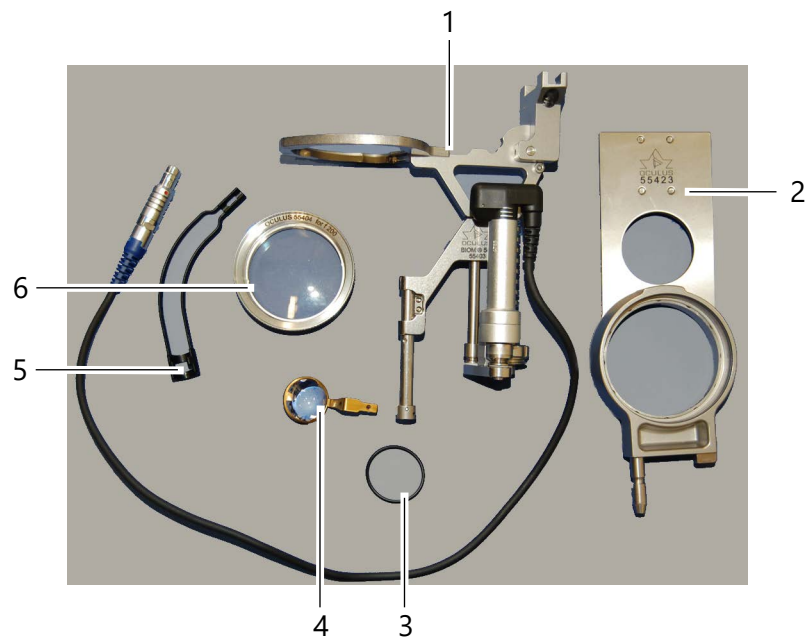


Fig. 2-1: Komponenten BIOM® 5cl

Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
1	BIOM® 5cl	4	Ophthalmoskopierlupe
2	Adapterplatte	5	Kabelführung
3	Antriebsriemen	6	Reduzierlinse

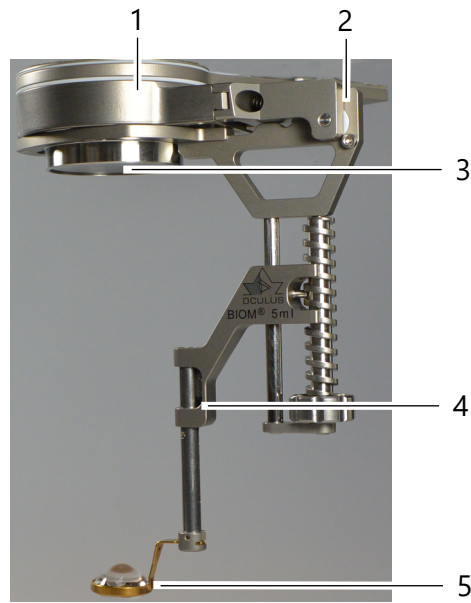


Fig. 2-2: Komponenten BIOM® 5ml

Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
1	Adapterplatte	4	Sicherheitseinschub
2	Gehäuse mit Schwenkmechanismus	5	Frontlupe
3	Reduzierlinse		

Eine Liste mit weiteren Komponenten, die Sie aufbereiten können, und Aufbereitungs-Zubehör finden Sie in → Kapitel 6 (Seite 31).

2.2 Vorbereitungen für Reinigung und Desinfektion



Empfehlung:


- Reinigen bzw. desinfizieren Sie das BIOM[®] 5 maschinell, aufgrund der deutlich höheren Wirksamkeit.
- Beginnen Sie mit der Vorbereitung sofort nach dem Eintreffen in der Aufbereitung.

2.2.1 BIOM[®] 5 demontieren


Bevor Sie das BIOM[®] 5 aufbereiten, müssen Sie es demontieren.



- 1
- Ziehen Sie das BIOM[®] 5 von der Adapterplatte ab. Schwenken Sie dazu das BIOM[®] 5 aus

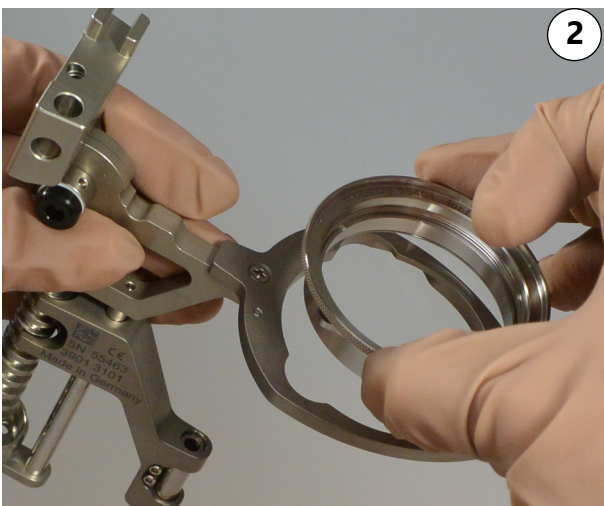

- 2
- Nehmen Sie die Reduzierlinse heraus und legen Sie sie auf die weiche Unterlage.

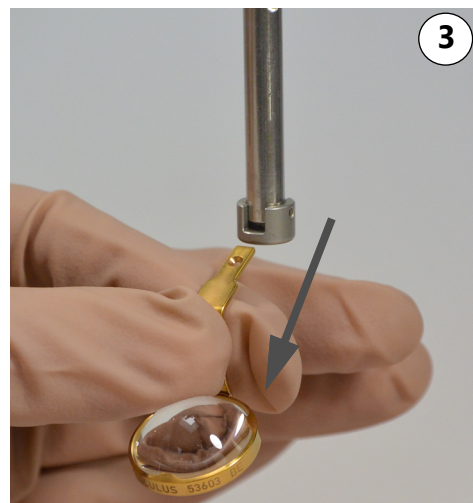

- 3
- Ziehen Sie die Frontlinse ab und legen Sie sie auf die weiche Unterlage.

Nur bei BIOM® 5c und BIOM® 5cl:



→ Lösen Sie die Kabelführung vom Stecker.



→ Ziehen Sie den Antriebsriemen ab.



Prüfen Sie vor dem Sterilisieren, ob das Antriebsmodul fest sitzt. Wenn es locker ist, müssen Sie die Innensechskantschraube, 2 mm, (1) des Antriebsmoduls anziehen bzw. rufen Sie Ihren Krankenhaustechniker.

2.2.2 Vorreinigen

Reinigungsmittel:

- kaltes Wasser
- Wasserpistole

Vorgehen:

- Legen Sie das BIOM® 5 für fünf Minuten in kaltes Wasser. Das BIOM® 5 muss ganz bedeckt sein.
- Spülen Sie die Spalten, Gelenke und Hohlräume (die markierte Stellen) für fünfzehn Sekunden mit der Wasserpistole.

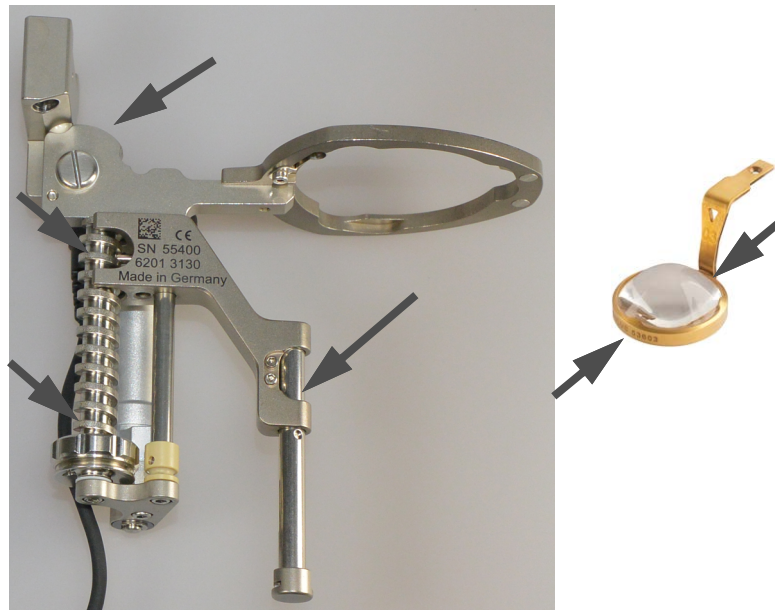


Fig. 2-3: Vorreinigen

Sie können die Komponenten nun maschinell → Kapitel 2.3 (Seite 15) oder manuell → Kapitel 2.4 (Seite 19) reinigen.

2.3 Maschinelle Reinigung/Desinfektion

2.3.1 Hinweise zur maschinellen Reinigung/Desinfektion

Reinigungs-Desinfektionsgerät (RDG)

→ Achten Sie darauf, dass das RDG die folgenden Kriterien erfüllt.

Es muss

- eine geprüfte Wirksamkeit (z.B. DGHM I- oder FDA-Zulassung bzw. CE-Kennzeichnung, DIN EN ISO 15883-1 konform) nachweisen.
- ein geprüftes Desinfektionsprogramm (mindestens 5 Minuten bei 90°C) zur thermischen Desinfektion einsetzen, da bei chemischer Desinfektion die Gefahr von Desinfektionsmittelrückständen auf den Produkten besteht. Der A_0 -Wert = 3000 muss erreicht werden.
- Wasser verwenden, dessen Qualität den Anforderungen der DIN EN 285 entsprechen (auch vollentsalztes Wasser mit einer elektrischen Leitfähigkeit von ca. $15\mu\text{S}/\text{cm}$).
- Luft zum Trocknen einsetzen, die den Anforderungen für Druckluft im Krankenhaus entspricht.

→ Achten Sie darauf, dass das Reinigungsmittel und das Desinfektionsmittel nicht miteinander reagieren.

Siehe auch → Kapitel 7 "Anhang" (Seite 32)

→ Prüfen und warten Sie das RDG regelmäßig gemäß hausinterner Vorgaben.

Reinigungs- und Desinfektionsmittel

→ Achten Sie darauf, dass das Reinigungs- und Desinfektionsmittel die folgenden Kriterien erfüllt.

Das Reinigungsmittel (z.B. neodisher MediClean (Konzentration 0,5%, Dr. Weigert, Hamburg) muss

- grundsätzlich für die Reinigung der Produkte geeignet sein
- kompatibel mit dem eingesetzten Desinfektionsmittel sein
- bei der DGHM (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie) gelistet sein



Hinweis

Funktionsstörungen und Oberflächen-Beschädigung durch alkalisches Reinigungsmittel

Wenn Sie ein alkalisches Reinigungsmittel einsetzen:

- Führen Sie eine ausreichende Neutralisation gemäß den Angaben des Herstellers durch.
- Prüfen Sie, ob die eingesetzten Chemikalien mit den Produkten kompatibel sind. Alkalische Reinigungsmittel können die Oberflächen der Produkte angreifen und zu Funktionsstörungen führen.

Sofern keine thermische Desinfektion eingesetzt wird (mindestens 5 Minuten bei 90°C), muss das Desinfektionsmittel

- über eine geprüfte Wirksamkeit verfügen (z.B. DGHM- oder FDA-Zulassung bzw. CE-Kennzeichnung)
- kompatibel mit dem eingesetzten Reinigungsmittel sein

→ Halten Sie die vom Hersteller des Reinigungs- und Desinfektionsmittels angegebenen Konzentrationen ein.

Reinigungsverfahren

Für die Validierung der Dampfautoklavierbarkeit der BIOM[®] Optiken wurde folgendes Reinigungsverfahren verwendet:
siehe → Kapitel 7 (Seite 32)



Führen Sie ein Reinigungsverfahren durch, das den Anforderungen Ihrer nationalen Normen entspricht.

2.3.2 Vorgehen

- Prüfen Sie, ob die Komponenten vorgereinigt wurden → Kapitel 2.2.2 (Seite 14).
- Legen Sie die Komponenten des BIOM[®] 5 in den Desinfektorkorb bzw. in ein Sterilisationssieb ein.
- Befestigen Sie die Lupen in den vorgesehenen Halterungen im Sieb, nicht befestigte Lupen können sonst verkratzt werden.
- Achten Sie darauf, dass die Komponenten sich nicht berühren, um die Effektivität der Reinigung /Desinfektion nicht zu beeinträchtigen.
- Legen Sie den Desinfektorkorb bzw. das Sterilisationssieb mit den Komponenten in das RDG ein.
Beachten Sie bei stapelbaren Desinfektorkörben bzw. Sterilisationssieben die Angaben des Herstellers.
- Lagern Sie die Lupen und Reduzierlinsen während der Reinigung möglichst vertikal, um Wasserflecken auf den Optiken zu vermeiden.

- Starten Sie das Spülprogramm, vgl. → Kapitel 7 (Seite 32), z. B.:
 - 3 Minuten Vorwäsche mit kaltem Wasser
 - Entleeren
 - 5 Minuten Reinigen bei 55 °C mit Reinigungsmittel
 - Entleeren
 - 3 Minuten Spülen mit kaltem vollentsalztem Wasser
 - Entleeren
 - 2 Minuten Spülen mit vollentsalztem Wasser
 - Entleeren
 - Nach Programm-Ende: Entnehmen Sie den Desinfektorkorb bzw. das Sterilisationssieb dem Desinfektionsgerät.
 - Prüfen Sie, ob das BIOM® 5 ggf. mit Druckluft nachgetrocknet werden muss.
-



- Führen Sie eine Funktionsprüfung durch, bevor Sie das BIOM® 5 dampfsterilisieren → Kapitel 2.6.1 (Seite 21).
-

Weitere Informationen zu diesen Arbeiten finden Sie in → Kapitel 7 (Seite 32).

OCULUS Sterilisations-Container

Sie können für das BIOM[®] 5 mit Zubehör den speziell konstruierten Sterilisations-Einsatz (OCULUS Art. Nr. 55185) verwenden.

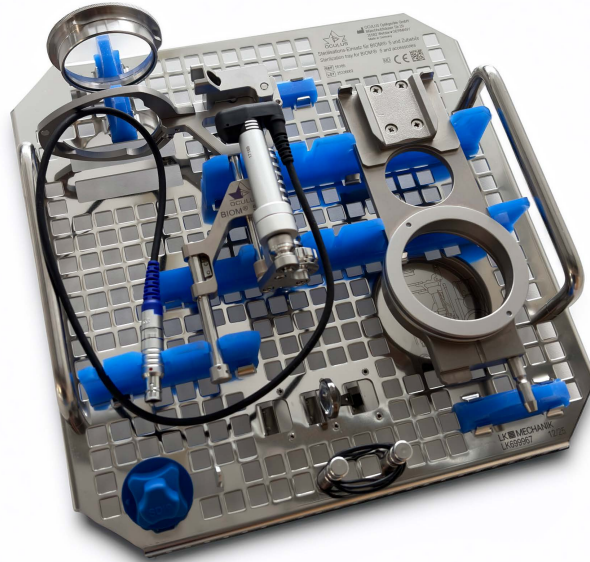


Fig. 2-4: Komponenten des BIOM[®] 5 auf dem Sterilisations-Einsatz

Abmessungen des OCULUS Sterilisations-Einsatzes

Breite	240mm
Tiefe	245mm
Höhe	53mm
Gesamthöhe, bestückt	80mm

Jeweils eine Adapterplatte, das BIOM[®] 5, eine Reduzierlinse, mindestens eine Frontlupe, 2 Gummi-Antriebsriemen, Sterilkappe für Rändelschraube, SDI[®] Bedienknopf gehören zusammen. Diese Geräte können in dem speziell vorgesehenen Einsatz in einen passenden Sterilisations-Container eingelegt werden und im Dampfautoklaven sterilisiert werden.

2.4 Manuelle Reinigung/Desinfektion

Für die manuelle Reinigung/Desinfektion wurde das unten stehende Verfahren validiert:



Wenn Sie manuell reinigen und desinfizieren, müssen Sie Ihre Vorgehensweise eigenverantwortlich verifizieren sowie produktspezifisch und methodisch validieren.

2.4.1 Reinigungsmittel

- Reinigungslösung mit 0,8% Reiniger (Cidezyme/Enzol von Johnson & Johnson)
- Wasser

2.4.2 Vorgehen



→ Führen Sie eine manuelle Desinfektion entsprechend der Anforderungen des VAH oder der entsprechenden Normen durch.

- Prüfen Sie, ob die Komponenten keine sichtbaren Verschmutzungen aufweisen → Kapitel 2.2.2 (Seite 14).
- Legen Sie die Komponenten für 5 Minuten bei 40 °C in die Reinigungslösung. Das BIOM[®] 5 muss ganz bedeckt sein.
- Spülen Sie die Komponenten für 5 Sekunden unter fließendem Wasser (statischer Druck 4,2bar).

2.5 Reinigen im Ultraschallbad (optional)



Hinweis

Eine zu hohe Schmutzbelastung der Flüssigkeit im Ultraschallbecken beeinträchtigt die Reinigungswirkung und fördert die Korrosionsgefahr. Kriterium ist eine optisch erkennbare Verschmutzung.

- Erneuern Sie die Reinigungslösung in Abhängigkeit von den Einsatzbedingungen. Diese muss regelmäßig erneuert werden, mindesten jedoch einmal täglich.
-
- Halten Sie bei der Ultraschallreinigung die vom Hersteller des Reinigungszusatzes angegebenen Einwirkzeiten sowie Konzentrationen ein, mindestens 3 Minuten.
 - Verwenden Sie dabei die vom Hersteller des Ultraschallbades vorgeschriebene Flüssigkeitsfüllmenge.
 - Beachten Sie die folgenden Hinweise:
 - BIOM[®] 5 in ausgeklapptem Zustand, Schwenkkopf vom BIOM[®] 5 abgewinkelt, einlegen
 - Lupenaufnahme des BIOM[®] 5 muss bis Anschlag ausgezogen sein

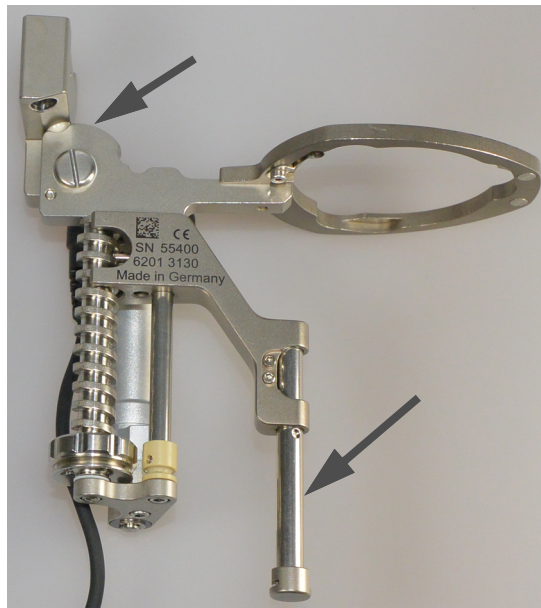


Fig. 2-5: Im Ultraschallbad reinigen

- Produkte müssen immer vollständig von der Reinigungslösung bedeckt sein
- Produkte nur auf Siebschalen legen
- Lupen an speziell konzipierten Halterungen aufhängen, um die Wirkung des Ultraschalls nicht zu beeinträchtigen und die Optiken nicht zu beschädigen.

2.6 Dampfsterilisation



Vorsicht

Personengefährdung durch mangelhafte Reinigung/Desinfektion

- Prüfen Sie die Komponenten nach der Reinigung/Desinfektion, ob diese makroskopisch sauber sind, d.h. frei von sichtbaren Verschmutzungen, Korrosion oder Beschädigungen.
- Bei Verschmutzungen: reinigen/desinfizieren Sie die Komponenten erneut.
- Bei Korrosion oder Beschädigung: Setzen Sie keine korrodierten oder beschädigten Komponenten erneut bei einer OP ein.


2.6.1 Funktionsprüfung vor der Dampfsterilisation

Sie müssen bewegliche Teile des BIOM[®] 5 vor der Verpackung und Dampfsterilisation prüfen, um die Funktion zu gewährleisten.


- Prüfen Sie alle beweglichen Teile des BIOM[®] 5.
- Achten Sie dabei besonders auf die korrekte Funktion
 - der Leichtgängigkeit des Kippgelenkes
 - des Sicherheitseinschubes der Frontlupe
 - des Fokussierknopfes



- Klappen Sie das BIOM[®] 5 in Richtung zur Adapterplatte. Achten Sie darauf, dass sich der Gehäusekörper ohne Widerstand verkippen lässt.

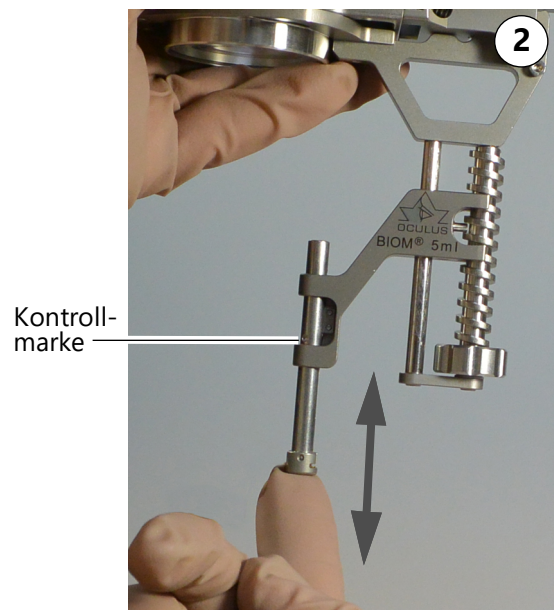

- Schieben Sie den Sicherheits-Einschub des Lupenhalters mehrfach auf und ab, um die Leichtgängigkeit zu kontrollieren. Nach der Prüfung muss der Stab bis zum Anschlag nach unten ausgezogen sein.

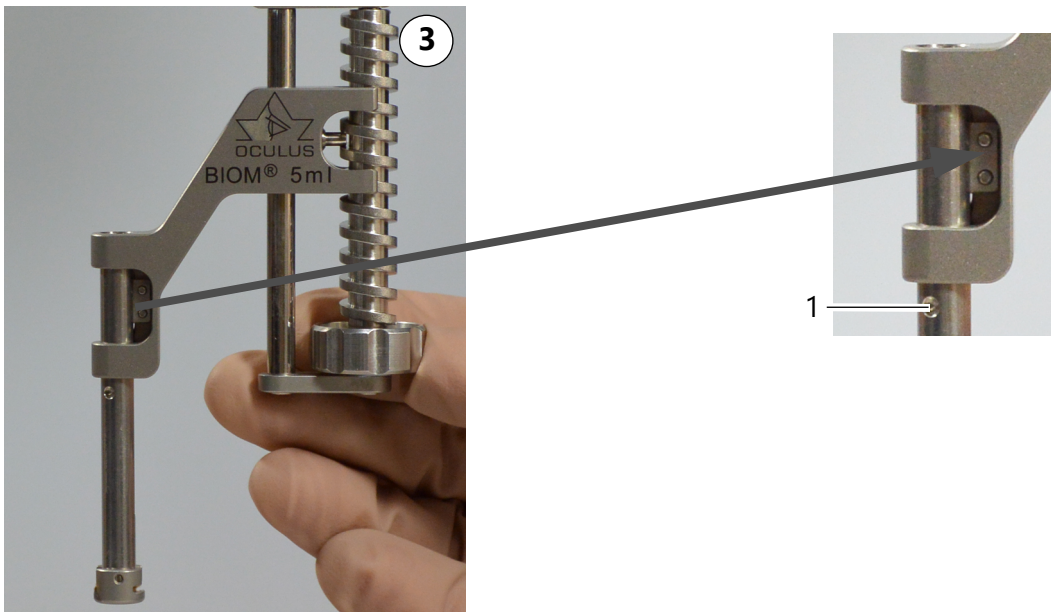

→ Prüfen Sie die leichte Verstellbarkeit des Drehrads und verkürzen Sie die Gesamtlänge, bis sich der Verstellkörper in oberster Position befindet.

→ Prüfen Sie, ob alle Befestigungsschrauben vorhanden sind (z. B. Schrauben der Passfeder des Sicherheitseinschubes). Die Kontrollmarke muss unterhalb der Führung sein.

Fig. 2-6: Sicherheitsfunktionen testen



Vorsicht

Personengefährdung durch beschädigte Komponente

- Falls eine Komponente den Funktionstest nicht bestanden hat, setzen Sie diese Komponente nicht bei einer OP ein.
- Schicken Sie die Komponenten an den OCULUS Service oder einen autorisierten Händler.

Vor dem Verschicken: Reinigen, desinfizieren und sterilisieren Sie die Komponenten. Beachten Sie dabei die Krankenhausvorschriften und die nationalen Vorschriften und Gesetze.

2.6.2 Schmieren

Bei Bedarf können Sie die beweglichen Teile des BIOM® 5 vor der Dampfsterilisation schmieren, um die Funktion zu gewährleisten.

Benötigtes Material:

- Fusselfreies Tuch
- Silikonfreies Pflegeöl, das für Dampfsterilisation geeignet ist



Hinweise

Funktionsstörungen und Oberflächen-Beschädigung durch silikonhaltiges Pflegeöl oder andere Mittel

Silikonbestandteile können sich bei der weiteren Behandlung (Dampfsterilisation) verfestigen und zur Schwergängigkeit des Instrumentes führen.

- Beachten Sie die Hinweise in der Anleitung des Pflegeöls.
- Verwenden Sie kein Pflegeöl auf Silikon-Basis.

Wenn Sie Mittel einsetzen, die in dieser Anleitung nicht genannt werden, müssen Sie nachweisen, dass diese Mittel den Anforderungen der DIN EN ISO 17664 entsprechen.

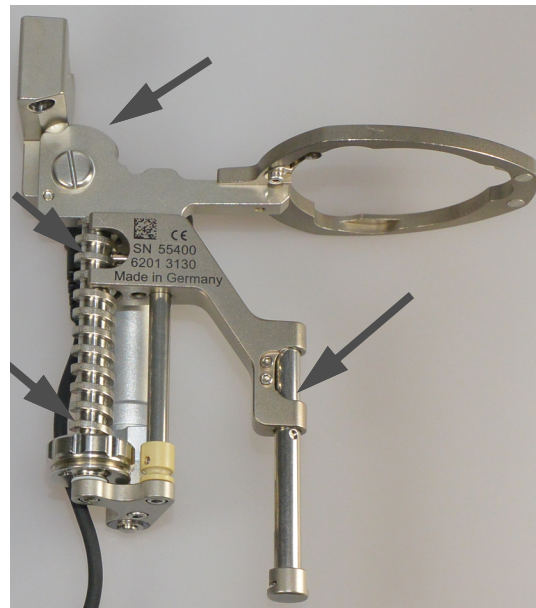


Fig. 2-7: Schmierer

- Schmieren Sie nur die mit Pfeilen markierten Stellen.
- Entfernen Sie überschüssiges Pflegeöl mit einem fusselfreien Tuch.

2.6.3 Verpacken

Der Sterilisationscontainer muss (inkl. Filtermaterial) folgende Kriterien erfüllen:

- entsprechend den Normen DIN EN 868 / ANSI AAMI ISO 11607
 - für die Dampfsterilisation geeignet (Temperaturbeständigkeit bis 137 °C, ausreichende Dampfdurchlässigkeit).
- Legen Sie vor der Sterilisation die Komponenten in einem Sterilisationsieb in den Sterilisationscontainer.

Wenn Sie Einmal-Sterilisationsverpackungen einsetzen, müssen diese ebenfalls den oben stehenden Kriterien entsprechen.

2.6.4 Dampfsterilisation durchführen

- Achten Sie darauf, dass nur gereinigte und desinfizierte Komponenten sterilisiert werden.

Die Optiken können doppelt eingeschweißt oder, in dem Sterilisations-Einsatz von OCULUS Optikgeräte GmbH befestigt, autoklaviert werden.

- Setzen Sie eines der folgenden Sterilisationsverfahren ein:

Fraktioniertes Vorvakuum-Verfahren

- Verwenden Sie einen validierten Dampfsterilisator, entsprechend DIN EN 13060 bzw. DIN EN 285 und DIN EN 17665-1/GOST R ISO 11134 (gültige Kommissionierung und produktspezifische Leistungsbeurteilung).

Die Parameter für das Verfahren sind wie folgt:

- 3 Vor-Vakuum-Phasen
- Sterilisationstemperatur: 132 °C
- Mindest-Haltezeit: 3 Minuten
- Trocknungszeit: 1 Minute

Gravitations-Verfahren:

Die minimalen Parameter dafür sind wie folgt:

- Sterilisationstemperatur: 132 °C
 - Mindest-Haltezeit: 15 Minuten
 - Trocknungszeit: 1 Minute
- Halten Sie mindestens die angegebenen Zeiten und Temperaturen ein. Sie können die angegebenen Zeiten und Temperaturen grundsätzlich überschreiten. Längere Sterilisationszeiten und höhere Temperaturen führen jedoch zu einer erhöhten Belastung des Materials, was eine vorzeitige Alterung der Produkte zur Folge haben kann.
- Die maximale Sterilisationstemperatur beträgt dabei 134 °C (zzgl. Toleranz entsprechend GOST R ISO 11134).



Falls Sie aus verfahrenstechnischen Gründen andere Sterilisationsverfahren, kürzere Sterilisationszeiten und niedrigere Temperaturen einsetzen, müssen Sie dies validieren.

3 Lagerung und Entsorgung

3.1 Lagerung

- Beachten Sie bei der Lagerung der aufbereiteten Produkten die Krankenhausvorschriften und die nationalen Vorschriften und Gesetze.

3.2 Entsorgung

Vor dem Entsorgen:

- Reinigen, desinfizieren und sterilisieren Sie die Komponenten. Beachten Sie dabei die Krankenhausvorschriften und die nationalen Vorschriften und Gesetze.

4 Gewährleistung und Service

Beachten Sie die folgenden Gewährleistungsbestimmungen:

- Wichtig ist, dass Sie vor bzw. bei Gebrauch die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise beachten.
- Sie haben auf die BIOM[®] 5 entsprechend der gesetzlichen Bestimmung Anspruch auf Gewährleistung. Ausgenommen von der Gewährleistung sind Verschleißteile wie das Antriebsmodul des BIOM[®] 5 sowie die Antriebsriemen. Auf das Antriebsmodul erhalten Sie eine Garantie über 100 Sterilisationszyklen, längstens 6 Monate ab Kaufdatum.
- Sämtliche Gewährleistungs- und Garantieansprüche erlöschen, wenn
 - Eingriffe in das BIOM[®] 5 von nicht autorisierten Personen vorgenommen werden. Denn durch unsachgemäße Änderungen und Instandsetzung können erhebliche Gefahren für den Benutzer und den Patienten entstehen.
 - die empfohlenen Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsanleitungen nicht beachtet werden.
 - durch unerlaubte Veränderungen, Missbrauch oder falsche Anwendungen Schäden entstehen.
- Transportschäden reklamieren Sie bei bzw. nach Auslieferung sofort bei dem Transportunternehmen und lassen Sie sich den Schaden auf dem Frachtbrief bestätigen, damit eine ordnungsgemäße Schadensregulierung möglich ist.
- Generell gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen in der Fassung des Kaufdatums.

5 Übersicht: Zulässige Sterilisationsverfahren – Artikelverzeichnis

Artikel- bezeichnung	Art.-Nr.	Reini- ungs- verfah- ren	Zulässige Sterilisationsverfahren				Plasma/ STER- RAD [®] 100S SHORT cycle	Plasma/ STER- RAD [®] 100NX [®] Standard cycle	V-Pro [®] Low Tempe- rature Sterili- zation Sys- tem1
			Dampf-Auto- klav		STATIM 5000S/G4				
			134 °C (273.2 °F)	132 °C (269.6 °F)	134 °C (273.2 °F); 3,5 min				
Deckel für Sterilisations- Container	10049877	manuell, maschi- nell	x	x					
Wanne für Sterilisations- Container	10049876	manuell, maschi- nell	x	x					
Einsatz für Sterilisations- Container	55185	manuell, maschi- nell	x	x		x	x	x	
Einsatz für Sterilisations- Container	55186				x	x	x	x	
BIOM [®] 5m	55462	manuell, maschi- nell	x	x	x	x	x	x	
BIOM [®] 5ml	55463	manuell, maschi- nell	x	x	x	x	x	x	
BIOM [®] 5c	55400	manuell, maschi- nell	x	x	x	x	x	x	
BIOM [®] 5cl	55403	manuell, maschi- nell	x	x	x	x	x	x	
Antriebsrie- men BIOM [®] 5c/cl	54176	manuell, maschi- nell	x	x	x	x	x	x	
Kabelführung BIOM [®] 5	54178	manuell, maschi- nell	x	x	x	max. 10 mal	max. 10 mal	x	
Adapter									
Adapterplatte	55423	manuell, maschi- nell	x	x	x	x	x	x	

Adapterplatte	55424	manuell, maschi- nell	x	x	x	x	x	x
Adapterplatte	55426	manuell, maschi- nell	x	x	x	x	x	x
Adapterplatte	55431	manuell, maschi- nell	x	x	x	x	x	x
Adapterplatte	55425	manuell, maschi- nell	x	x	x	x	x	x
Adapterplatte	10007617	manuell, maschi- nell	x	x	x	x	x	x

Artikel- bezeichnung	Art.- Nr.	Reini- ungs- verfah- ren	Zulässige Sterilisationsverfahren					
			Dampf-Auto- klav		STATIM 5000S/G4	Plasma/ STER- RAD® 100S SHORT cycle	Plasma/ STER- RAD® 100NX® Standard cycle	V-Pro® Low Tempe- rature Steriliza- tion System1
			134°C (273. 2°F)	132°C (269.6 °F)	134°C (273.2°F); 3,5 min			
Zubehör für Adapter								
Sterilkappe für Rändel- schraube	54580	manuell	x	x	x	x	x	x
SDI®								
SDI® II e SDI® II m SDI® 3 c SDI® 4m SDI® 4e SDI® 4c	54800 54802 54805 54810 54812 54815 54820 54830 54300 54302 54305 54310 54312 54315 54320 54330 54331 54332	Sterilisie- rung nicht möglich. Wisch- desinfek- tion erlaubt, analog Operati- ons- mikros- kop						
Gummikappe für SDI® II, SDI® 3 und SDI® 4	54335	manuell, maschi- nell	x	x	x	x		

Artikel- bezeichnung	Art.- Nr.	Reini- ungs- verfahren	Zulässige Sterilisationsverfahren						
			Dampf-Auto- klav		STATIM 5000S/ G4	Plasma/ STER- RAD® 100S SHORT cycle	Plasma/ STER- RAD® 100NX® Standard cycle	V-Pro® Low Tempe- rature Sterili- zation System1	
			134°C (273.2 °F)	132°C (269.6 °F)	134°C (273.2°F) 3,5 min				
Reduzierlinsen									
Reduzierlinse für f=175 an BIOM® 5m/c	55401	manuell, maschinell	x	x	x	x	x	x	x
Reduzierlinse für f=200 an BIOM® 5ml/cl	55404	manuell, maschinell	x	x	x	x	x	x	x
Reduzierlinse für f=200 an BIOM® 5m/c	55405	manuell, maschinell	x	x	x	x	x	x	x
Frontlupen für BIOM® 5									
Hi Res Makula Lupe	53606	manuell, maschinell	x	x	x	x	x	x	x
Wide Field High Definition Mini Lupe	53605	manuell, maschinell	x	x	x	x	x	x	x
90 D Lupe	53604	manuell, maschinell	x	x	x	x	x	x	x
WiFi-HD Lupe	53603	manuell, maschinell	x	x	x	x	x	x	x
Wide-Field Lupe	53602	manuell, maschinell	x	x	x	x	x	x	x
Mini Wide-Field Lupe	53601	manuell, maschinell	x	x	x	x	x	x	x

¹ die folgenden V-Pro® Systeme wurden getestet (Sterilisationsmittel VAPROX® HC):

V-Pro® 1 Low Temperature Sterilization System

V-Pro® 1 Plus Low Temperature Sterilization System

V-Pro® 1 maX Low Temperature Sterilization System

V-Pro® 60 Low Temperature Sterilization System

6 Verbrauchsmaterial und sterilisierbares Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung
54335	Sterilisierbare Gummikappe für SDI® II, SDI® 3 und SDI® 4 (5er Pack)
54580	Sterilisierbare Abdeckkappe für Rändelschraube (5er Pack)
54176	Sterilisierbarer Antriebsriemen (10er Pack)
54178	Kabelführung für BIOM® 5c (5er Pack)
10049877	Deckel für Sterilisations-Container für BIOM® 5 und Zubehör
10049876	Wanne für Sterilisations-Container für BIOM® 5 und Zubehör
55185	Einsatz für Sterilisations-Container für BIOM® 5 und Zubehör
54187	Lupenspülhalterung
55190	Papierfilter für Sterilisations-Container (100 Stck.-Pack)
01 54538 01 002	Rändelschraube M3 für Aufnahmeschwalbe 54511, 54537, 54538, 54552, 54622, 54623, 54121, 54142, 54144, 54622 01 000, 54623 01 000, 54552 01 000
546391	Satz Rändelschrauben (2er Pack) zur Zwischenplatte für Möller Mikroskop



Vorsicht

Personenschaden durch kontaminiertes BIOM® 5 und Komponenten

- Vor dem Rücksenden an OCULUS: Bereiten Sie das BIOM® 5 und die sterilisierbaren Komponenten entsprechend dieser Aufbereitungsanleitung auf.
- Senden Sie die OCULUS Produkte nur erkennbar aufbereitet an OCULUS zurück.

7 Anhang

Produkt	Modelle und das Zubehör des BIOM [®] 5. Eine genaue Auflistung finden Sie in der Aufbereitungsanleitung BIOM [®] 5	
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> ■ Diese Anweisung stellt nur eine Hilfe zum Reinigen, Desinfizieren und Sterilisieren dar. Ausführliche Informationen entnehmen Sie der Aufbereitungsanleitung zum BIOM[®] 5. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Abweichende Sterilisationsverfahren müssen vom Anwender validiert werden. ■ Reinigen Sie bzw. desinfizieren Sie das BIOM[®] 5 maschinell, aufgrund der deutlich höheren Wirksamkeit.
Prozess-Anweisungen	Aufgrund des Produktdesigns und der verwendeten Materialien kann kein definiertes Limit von max. durchführbaren Aufbereitungszyklen festgelegt werden. Die Lebensdauer der Produkte wird durch deren Funktion und den schonenden Umgang beeinflusst.	Defekte Produkte <ul style="list-style-type: none"> ■ Vor dem Verschicken: Reinigen, desinfizieren und sterilisieren Sie die Komponenten. Beachten Sie dabei die Krankenhausvorschriften und die nationalen Vorschriften und Gesetze. ■ Schicken Sie die Komponenten an den OCULUSService oder einen autorisierten Händler.
Vorbereitung zu Dekontamination	Keine besonderen Maßnahmen notwendig.	
Vorbereitungen zum Einsatzort	BIOM [®] 5 vom Mikroskop abbauen	
Vorbereitung in der Aufbereitung	BIOM [®] 5 demontieren	
Transport und Lagerung	Sichere Lagerung in einem geschlossenen Behältnis und Transport der Produkte zum Aufbereitungsort	
Vorreinigung	Material: kaltes Wasser, Wasserpistole Vorgehen: <ul style="list-style-type: none"> ■ BIOM[®] 5 für fünf Minuten in kaltes Wasser legen. Das BIOM[®] 5 muss ganz bedeckt sein. ■ Spalten, Gelenke und Hohlräume (die markierte Stellen) für fünfzehn Sekunden mit der Wasserpistole spülen. 	
Reinigung/Desinfektion	Maschinelle Reinigung/Desinfektion Material: RDG (mit therm. Desinfektionsprogramm 5 Min bei 90°C, für A ₀ -Wert=3000), Reinigungsmittel RDG, kaltes Wasser, vollentsalztes Wasser Vorgehen: <ul style="list-style-type: none"> ■ 3 min Vorwäsche mit kaltem Wasser ■ Entleeren ■ 5 min Reinigen bei 55°C mit neodisher MediClean (Konzentration 0,5%, Dr. Weigert, Hamburg) ■ Entleeren ■ 3 min Spülen mit kaltem vollentsalztem Wasser ■ Entleeren ■ 2 min Spülen mit vollentsalztem Wasser ■ Entleeren ■ Prüfen, ob das BIOM[®] 5 ggf. mit Druckluft nachgetrocknet werden muss 	Manuelle Reinigung/Desinfektion Material: Reinigungslösung mit 0,8% Reiniger (Cidezyme/Enzol von Johnson & Johnson), Wasser Vorgehen: <ul style="list-style-type: none"> ■ Prüfen Sie, ob die Komponenten keine sichtbaren Verschmutzungen aufweisen. ■ Legen Sie die Komponenten für 5 Minuten bei 40°C in die Reinigungslösung. Das BIOM[®] 5 muss ganz bedeckt sein. ■ Spülen Sie die Komponenten für 5 Sekunden unter fließendem Wasser (statischer Druck 4,2 bar). ■ Optional: Reinigung im Ultraschallbad

Funktionsprüfung	Prüfen <ul style="list-style-type: none"> ■ der Leichtgängigkeit des Kippgelenkes ■ des Sicherheitseinschubes der Frontlupe. Nach der Prüfung muss sich die Kontrollmarke an Position (1) befinden ■ des Fokussierknopfes ■ ob alle Befestigungsschrauben vorhanden sind 	
Transport	Verpacken Sie die Produkte bzw. das Sterilisationssieb mit den Komponenten entsprechend den Normen DIN EN 868 / ANSI AAMI ISO 11607	
Sterilisation	Fraktioniertes Vorvakuum-Verfahren Material: validierter Dampfsterilisator, entsprechend DIN EN 13060 bzw. DIN EN 285 und DIN EN 17665-1/ GOST R ISO 11134 Parameter: <ul style="list-style-type: none"> ■ 3 Vor-Vakuum-Phasen ■ Sterilisationstemperatur: 132°C ■ Mindest-Haltezeit: 3 min ■ Trocknungszeit: 1 min 	Gravitations-Verfahren: Minimale Parameter: <ul style="list-style-type: none"> ■ Sterilisationstemperatur: 132°C ■ Mindest-Haltezeit: 15 min ■ Trocknungszeit: 1 min Die maximale Sterilisationstemperatur beträgt dabei 134°C (zzgl. Toleranz entsprechend GOST R ISO 11134.
In Studien validierte Geräte und Mittel	Spülmaschine: Miele G 7735 CD	Reinigungsmittel: neodisher MediClean (Konzentration 0,5%, Dr. Weigert, Hamburg)

WWW.OCULUS.DE

Headquarter:

OCULUS Optikgeräte GmbH

Münchholzhäuser Str. 29 • 35582 Wetzlar • GERMANY

Tel.: +49 641 2005-0 • Fax: +49 641 2005-255

E-Mail: sales@oculus.de • www.oculussurgical.de

Distributor USA:

OCULUS Surgical, Inc.

9850 SW Discovery Way • Port Saint Lucie • FL 34987 • USA

Tel: +1 772-236-2622

Tel. +1 855-SDIBIOM (Toll free in U.S.)

www.oculussurgical.com

G/55185/DE
Rev03

